Initial C™: Kits stériles à usage unique pour clavicule

Initial C™ - Composition des kits

Indications : Les implants de la gamme INITIAL C™ sont dédiés à la fixation des fractures, retards de consolidation, pseudarthroses et ostéotomies de la clavicule chez l'adulte.

Contre-indications:

- Altération vasculaire importante, dévitalisation osseuse.
- Grossesse.
- Infections aiguës ou chroniques locales ou systémiques.
- Absences de couvertures musculo-cutanées, déficiences vasculaires sévères affectant la partie concernée.
- Altération osseuse ne permettant pas une tenue correcte des vis dans l'os.
- Déficience musculaire ou neurologique, troubles comportementaux risquant de soumettre l'ostéosynthèse à des contraintes mécaniques anormales.
- Allergie à l'un des composants ou sensibilité aux corps étrangers.
- Graves problèmes de non-observance, troubles mentaux ou neurologiques, incapacité de se conformer aux instructions en ce qui concerne les soins post-opératoires.
- Etat physique et/ou mental instable.

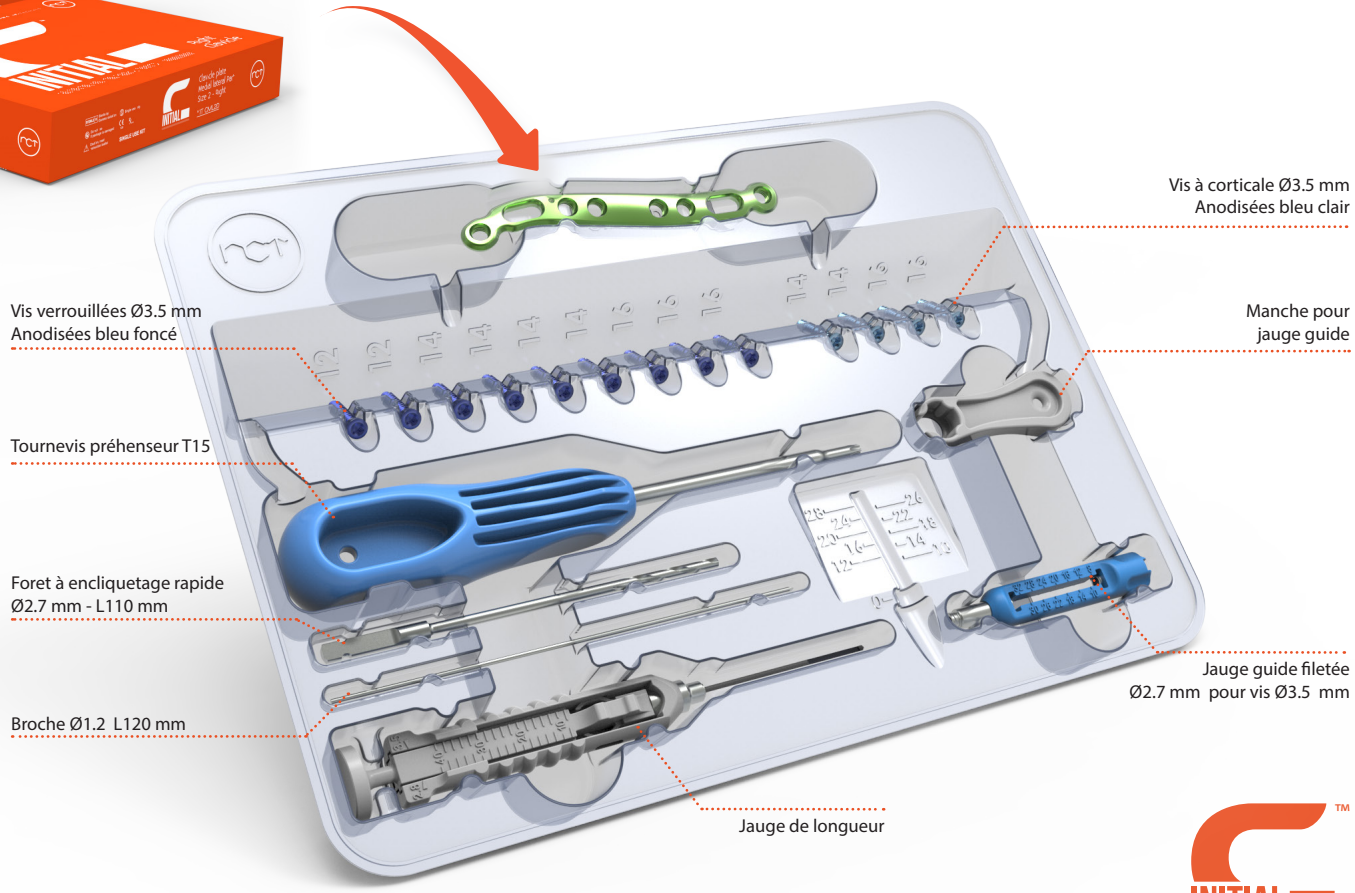

NEWCLIP-TECHNICS

INITIAL™

Initial C™: Kits stériles à usage unique pour clavicule

Initial C™ - Composition des kits

> Références kits Initial C™ - Plaques du 1/3 moyen

PLAQUES DU 1/3 MOYEN	
Réf.	Désignation
KIT-CM2D	Kit clavicule - 1/3 moyen - Taille 2 - Droite
KIT-CM2G	Kit clavicule - 1/3 moyen - Taille 2 - Gauche
KIT- CML1D	Kit clavicule - 1/3 moyen latéral - Taille 1 - Droite
KIT- CML1G	Kit clavicule - 1/3 moyen latéral - Taille 1 - Gauche
KIT- CML2D	Kit clavicule - 1/3 moyen latéral - Taille 2 - Droite
KIT- CML2G	Kit clavicule - 1/3 moyen latéral - Taille 2 - Gauche

PLAQUES FORMABLES DU 1/3 MOYEN	
Réf.	Désignation
KIT-CBM1D	Kit clavicule - Formable - 1/3 moyen - Taille 1 - Droite
KIT-CBM1G	Kit clavicule - Formable - 1/3 moyen - Taille 1 - Gauche
KIT-CBM2D	Kit clavicule - Formable - 1/3 moyen - Taille 2 - Droite
KIT-CBM2G	Kit clavicule - Formable - 1/3 moyen - Taille 2 - Gauche

COMPOSITION DES KITS INITIAL C™ - IMPLANTS			QUANTITÉ PAR KIT				
	Réf.	Désignation	KIT-CBM1D/G	KIT-CM2D/G	KIT-CBM2D/G	KIT- CML1D/G	KIT- CML2D/G
PLAQUES	CBTDM1D ou CBTGM1D	Plaque formable pour clavicule - 1/3 moyen - Taille 1 - Droite ou gauche	1	-	-	-	-
	CTDM2D ou CTGM2D	Plaque pour clavicule- 1/3 moyen - Taille 2 - Droite ou gauche	-	1	-	-	-
	CBTDM2D ou CBTGM2D	Plaque formable pour clavicule - 1/3 moyen - Taille 2 - Droite ou gauche	-	-	1	-	-
	CTDML1D ou CTGML1D	Plaque pour clavicule - 1/3 moyen latéral - Taille 1- Droite ou gauche	-	-	-	1	-
	CTDML2D ou CTGML2D	Plaque pour clavicule - 1/3 moyen latéral - Taille 2 - Droite ou gauche	-	-	-	-	1
VIS STANDARD À CORTICALE Ø3.5 MM	CT3.5L12D	Vis standard à corticale Ø3.5 mm - L 12 mm	1	-	1	1	-
	CT3.5L14D	Vis standard à corticale Ø3.5 mm - L 14 mm	1	2	1	1	2
	CT3.5L16D	Vis standard à corticale Ø3.5 mm - L 16 mm	1	2	1	1	2
	CT3.5L18D	Vis standard à corticale Ø3.5 mm - L 18 mm	1	-	1	1	-
VIS VERROUILLÉES Ø3.5 MM	SOT3.5L12D	Vis verrouillée Ø3.5 mm - L 12 mm	1	1	2	1	2
	SOT3.5L14D	Vis verrouillée Ø3.5 mm - L 14 mm	2	3	4	2	4
	SOT3.5L16D	Vis verrouillée Ø3.5 mm - L 16 mm	2	3	3	2	3
	SOT3.5L18D	Vis verrouillée Ø3.5 mm - L 18 mm	1	1	2	1	-

> Références kits Initial C™ - Plaque latérales

PLAQUES LATÉRALES	
Réf.	Désignation
KIT-CL1D	Kit clavicule - Latéral - Taille 1 - Droite
KIT-CL1G	Kit clavicule - Latéral - Taille 1 - Gauche
KIT-CL2D	Kit clavicule - Latéral - Taille 2 - Droite
KIT-CL2G	Kit clavicule - Latéral - Taille 2 - Gauche
KIT-CBL2D	Kit clavicule - Formable - Latéral - Taille 2 - Droite
KIT-CBL2G	Kit clavicule - Formable - Latéral - Taille 2 - Gauche

COMPOSITION DES KITS INITIAL C™ - IMPLANTS			QUANTITÉ PAR KIT		
	Réf.	Désignation	KIT-CL1D/G	KIT-CL2D/G	KIT-CBL2D/G
PLAQUES	CTDL1D ou CTGL1D	Plaque pour clavicule - Latérale - Taille 1 - Droite ou gauche	1	-	-
	CTDL2D ou CTGL2D	Plaque pour clavicule - Latérale - Taille 2 - Droite ou gauche	-	1	-
	CBTDL2D ou CBTGL2D	Plaque formable pour clavicule - Latérale - Taille 2 - Droite ou gauche	-	-	1
VIS VERROUILLÉES Ø2.8 MM	SDT2.8L10D	Vis verrouillée Ø2.8 mm - L 10 mm	1	1	1
	SDT2.8L12D	Vis verrouillée Ø2.8 mm - L 12 mm	2	2	2
	SDT2.8L14D	Vis verrouillée Ø2.8 mm - L 14 mm	2	2	2
	SDT2.8L16D	Vis verrouillée Ø2.8 mm - L 16 mm	2	2	2
	SDT2.8L18D	Vis verrouillée Ø2.8 mm - L 18 mm	1	1	1
VIS STANDARD À CORTICALE Ø3.5 MM	CT3.5L12D	Vis standard à corticale Ø3.5 mm - L 12 mm	1	1	1
	CT3.5L14D	Vis standard à corticale Ø3.5 mm - L 14 mm	1	1	1
	CT3.5L16D	Vis standard à corticale Ø3.5 mm - L 16 mm	1	1	1
	CT3.5L18D	Vis standard à corticale Ø3.5 mm - L 18 mm	-	1	1
VIS VERROUILLÉES Ø3.5 MM	SOT3.5L12D	Vis verrouillée Ø3.5 mm - L 12 mm	1	1	1
	SOT3.5L14D	Vis verrouillée Ø3.5 mm - L 14 mm	2	2	2
	SOT3.5L16D	Vis verrouillée Ø3.5 mm - L 16 mm	1	2	2
	SOT3.5L18D	Vis verrouillée Ø3.5 mm - L 18 mm	1	1	3

Illustrations non contractuelles.

Avant toute utilisation des dispositifs NCT, lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage. - CE1639 SGS BE - Dispositifs de classe IIb - 05/2020 - ED5 - FR - Initial C - CPK

NEWCLIP TECHNICS
PA de la Lande Saint Martin - 45 rue des Garottières
44115 Haute Goulaine (France)
Tél. : +33 (0)2 28 21 37 12 - Fax : +33 (0)2 40 63 68 37
Mail : commande@newcliptechnics.com
www.newcliptechnics.com

Les informations données sont destinées à présenter les produits NCT. Les chirurgiens doivent toujours consulter l'étiquette d'identification du produit et la notice d'utilisation incluant les instructions de nettoyage et de stérilisation avant utilisation de tout produit Newclip Technics.
Certains produits ne sont pas disponibles sur tous les marchés. La disponibilité des produits est sujette aux pratiques règlementaires et/ou médicales en vigueur sur les différents marchés. Veuillez contacter votre représentant Newclip Technics si vous avez des questions concernant la disponibilité des produits Newclip Technics dans votre pays.