INAXIS.

COMPOSITION DU KIT

INAXIS.

Destination :
Les implants de la gamme Stand-Alone Screws sont dédiés à la fixation des fractures, ostéotomies et arthrodèses osseuses chez l'adulte, appropriées à la taille du dispositif.

Contre-indications :

- Grossesse.
- Infections aiguës ou chroniques locales ou systémiques.
- Allergie à l'un des composants ou sensibilité aux corps étrangers.

3 CONFIGURATIONS MAJEURES POUR LE KIT INAXIS

1 • KIT COMPLET

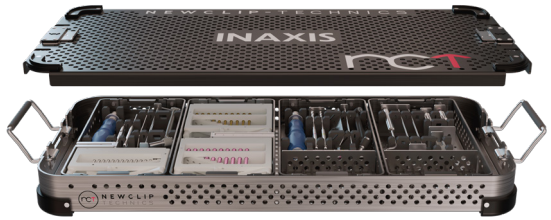

- Instrumentation et vis Ø2.0 mm
- Instrumentation Ø3.0 et Ø4.0 mm
- Vis Ø3.0 et Ø4.0 mm
- Instrumentation spécifique

Pages 3 & 4

2 • KIT 2 OPTIONS

(BASE 1/2)

Choix de 2 modules parmi 4 options :

- Instrumentation et vis Ø2.0 mm*
- Instrumentation Ø3.0 et Ø4.0 mm
- Vis Ø3.0 et Ø4.0 mm*
- Instrumentation spécifique

Page 5

3 • KIT INSTRUMENTATION SPÉCIFIQUE

(BASE 1/4)

- Instrumentation spécifique

Page 6

*Implants également disponibles en version stérile

1. Kit complet (1/2)

B1: Instrumentation & vis Ø2.0mm
(ANC1572/B1 + ANC1572/R1)

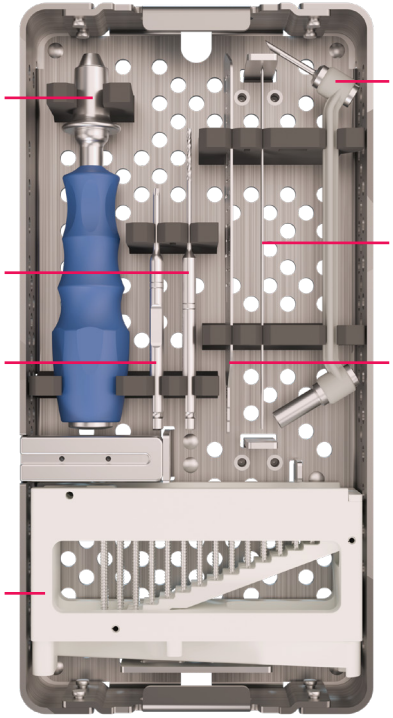

ANC350 Manche à encliquetage rapide AO Ø4.5 mm - Taille 1

ANC1496 Foret à encliquetage rapide Ø1.6 mm - canulé Ø0.9 mm - L100 mm (x2)

ANC1561 Tournevis préhenseur T7 à encliquetage rapide - canulé Ø0.9 mm (x2)

ANC1572/R1 Vis Ø2.0 mm - Rack de vis

ANC1565 Guide broche Ø0.9 mm / canon protecteur de tissus mous pour vis d'extrémité

ANC1535 Broche Ø0.8 - L120 mm (x3)

ANC1531 Jauge différentielle pour broche L120 mm / fantôme pour vis d'extrémité

B2: Instrumentation Ø3.0 & Ø4.0 mm
(ANC1572/B2)

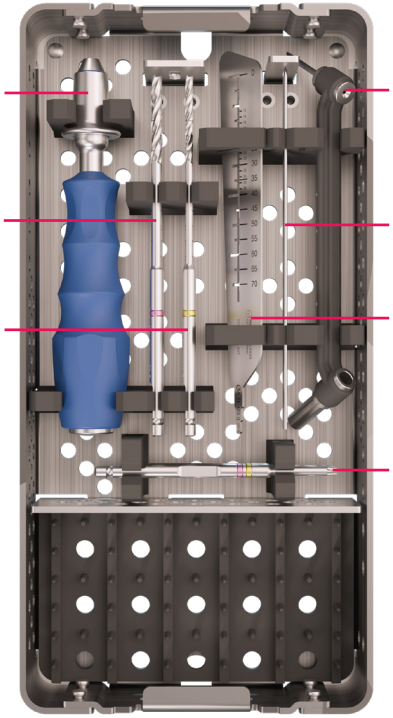

AN350 Manche à encliquetage rapide AO Ø4.5 mm - Taille 1

ANC1729 Foret à encliquetage rapide Ø3.5 mm - canulé Ø1.3 mm - L120 mm (x2)

ANC1497 Foret à encliquetage rapide Ø2.7 mm - canulé Ø1.3 mm - L120 mm (x2)

ANC1566 Guide double : Guide broche Ø1.3 mm / Canon protecteur de tissus mous pour vis d'extrémité

ANC1570 Broche Ø1.2 - L120 mm (x3)

ANC1531 Jauge différentielle pour broche L120 mm / Fantôme pour vis d'extrémité

ANC1562 Tournevis préhenseur T10 à encliquetage rapide - canulé Ø1.3 mm (x2)

1. Kit complet (2/2)

B3: instrumentation spécifique
(ANC1572/B3)

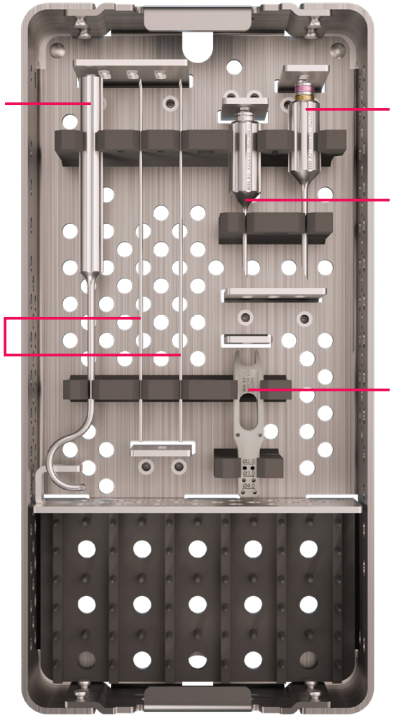

ANC1733 Passe-fil pour cerclage des os d'extrémité - Ø1.2 mm

ANC1570 Broche Ø1.2 - L120 mm (x4)

ANC1731 Outil de réduction - canulé Ø1.3 mm

ANC1798 Outil de réduction - canulé Ø0.9 mm

ANC1732 Guide d'insertion et de retrait pour vis d'extrémité Ø2.0, Ø3.0 et Ø4.0 mm

B4: Vis Ø3.0 & Ø4.0 mm
(ANC1572/B4 + ANC1572/R2 + ANC1572/R3)

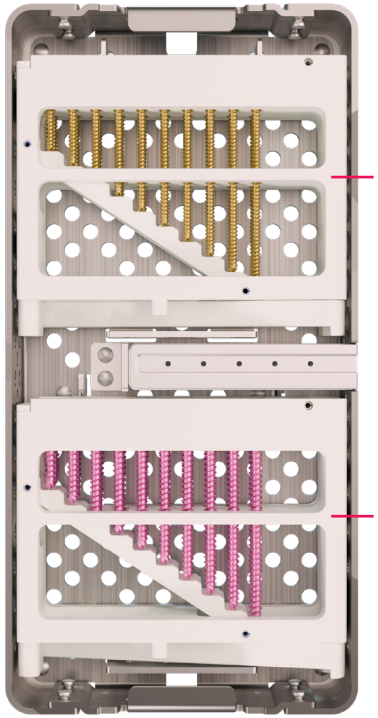

ANC1572/R2 Vis Ø3.0 mm - Rack de vis

ANC1572/R3 Vis Ø4.0 mm - Rack de vis

2. Kit 2 options

Choix de 2 modules parmi les 4 suivants :

B1: Instrumentation & vis Ø2.0mm
(ANC1572/B1 + ANC1572/R1)

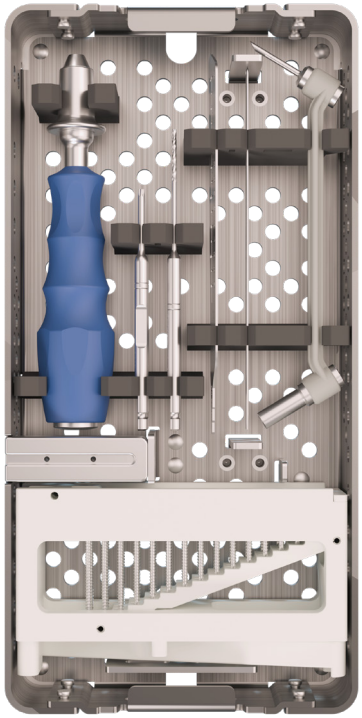

B2: Instrumentation Ø3.0 & Ø4.0 mm
(ANC1572/B2)

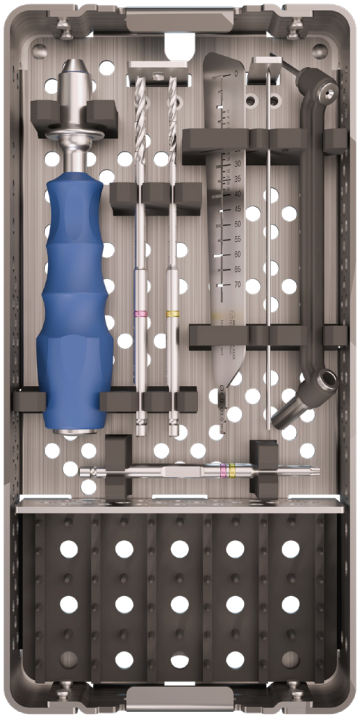

B3: Instrumentation spécifique
(ANC1572/B3)

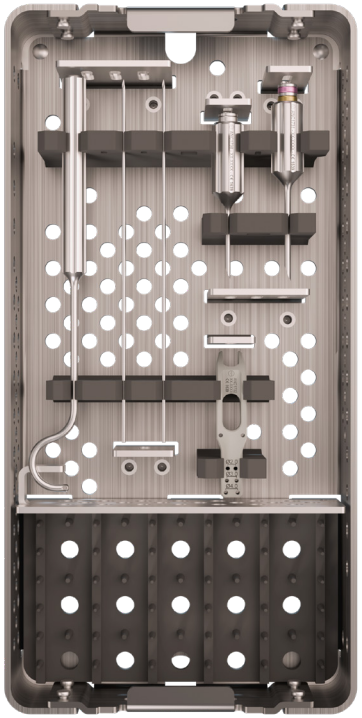

B4: Vis Ø3.0 & Ø4.0 mm
(ANC1572/B4 + ANC1572/R2 + ANC1572/R3)

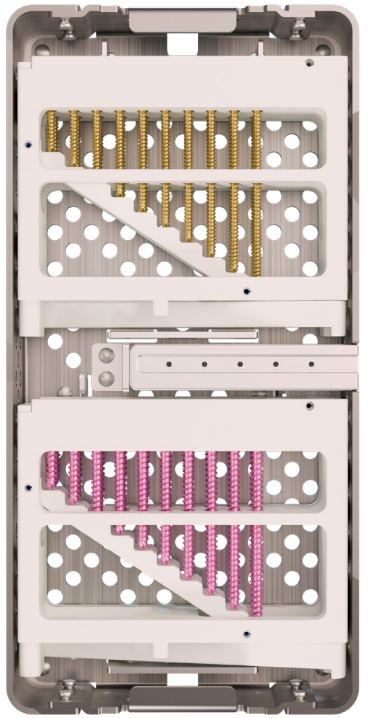

3. Kit Instrumentation spécifique

B3: Instrumentation spécifique
(ANC1572/B3)

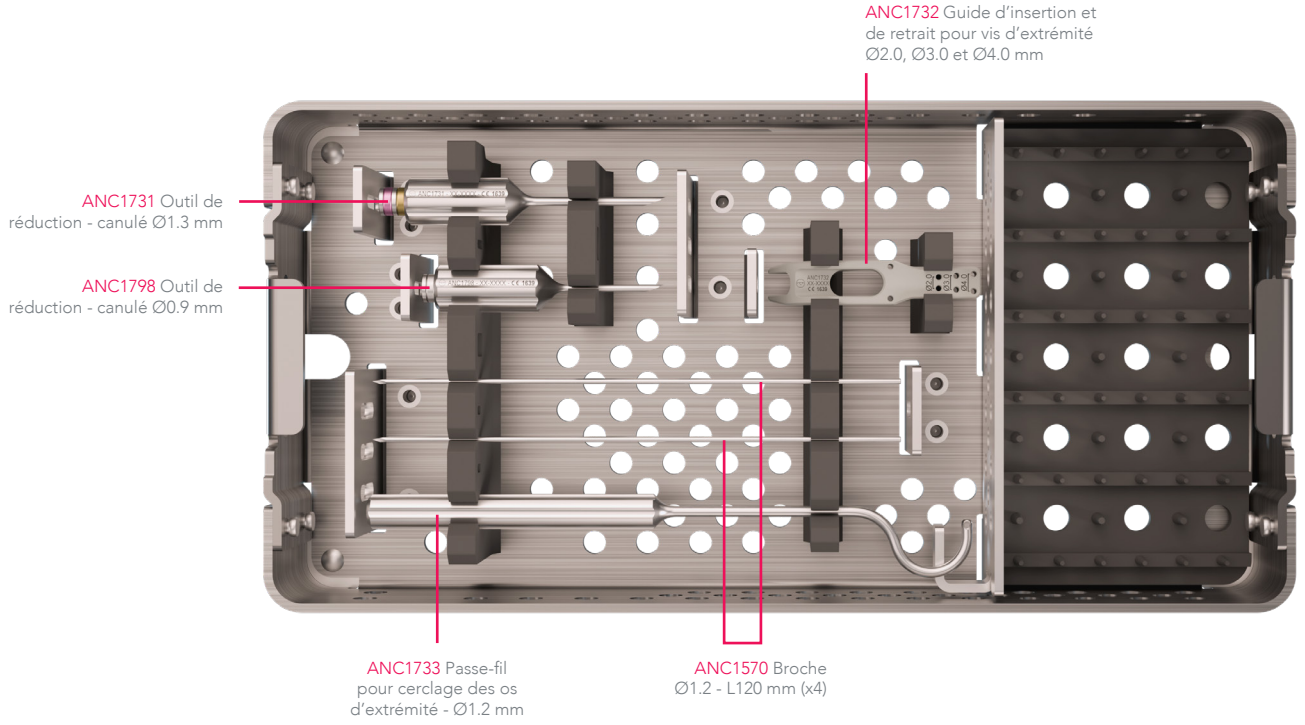

Références des implants et conteneurs non présentés plus haut.

Vis de neutralisation d'extrémité

Ref.	Désignation
H0.9GLT2.0L12D à H0.9GLT2.0L40D	Vis de neutralisation d'extrémité* Ø2.0 mm - canule Ø0.9 - filet complet -L12 à 40 mm - (2mm d'incrémentation)
H1.3GLT3.0L25D à H1.3GLT3.0L70D	Vis de neutralisation d'extrémité** Ø3.0 mm - canule Ø1.3 - filet complet L25 à 70 mm (5mm d'incrémentation)
H1.3GLT4.0L25D à H1.3GLT4.0L70D	Vis de neutralisation d'extrémité*** Ø4.0 mm - canule Ø1.3 - filet complet L25 à 70 mm (5mm d'incrémentation)

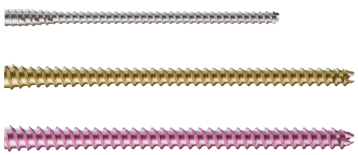

*Non anodisées
**Anodisés en doré
***Anodisées en rose

Kit complet

Ref.	Désignation
ANC1434/B1	Conteneur - 1 niveau - Taille 1 - Base
ANC1573/C	Conteneur InAxis - Taille 1 - Couvercle

Kit 2 options

Ref.	Désignation
ANC1434/B4	Conteneur - 1 niveau - Taille 1/2 - Base
ANC1572/C2	Conteneur InAxis - Taille 1/2 - Couvercle

Kit 1 option

Ref.	Désignation
ANC1572/C1	Conteneur InAxis - Taille 1/4 - Couvercle

Ces informations ont pour intérêt de présenter la gamme de dispositifs médicaux de Newclip Technics. Avant toute utilisation des dispositifs Newclip Technics, lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage et la notice d'utilisation incluant les instructions de nettoyage et de stérilisation. Ces produits doivent être manipulés et/ou implantés par des personnes formées, qualifiées et ayant pris connaissance de la notice d'utilisation. Le chirurgien reste responsable de son propre jugement professionnel et clinique avant toute utilisation de produits spécifiques sur un patient donné. Certains produits ne sont pas disponibles sur tous les marchés. La disponibilité des produits est sujette aux pratiques réglementaires et/ou médicales en vigueur sur les différents marchés. Veuillez contacter votre représentant Newclip Technics si vous avez des questions concernant la disponibilité des produits Newclip Technics dans votre pays.

Fabricant : Newclip Technics - CPK FR - Inaxis - Ed.1 - 07/2026- Dispositifs de classe IIb - CE1639 SGS BE - Avant toute utilisation des dispositifs Newclip Technics, lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage. Ces produits doivent être manipulés et/ou implantés par des personnes formées, qualifiées et ayant pris connaissance de la notice d'utilisation. Newclip Technics - 45 rue des Garottières - 44115 Haute Goulaine, France. Nos filiales : Newclip USA - Newclip Australia - Newclip Germany - Newclip Japan - Newclip Iberia - Newclip Belgium - Newclip Italia - Newclip UK.

newcliptechnics.com